



Medtronic

Engineering the extraordinary



Sistema Smart MDI

Perchè il CGM da solo non basta.

Registra automaticamente e in tempo reale gli andamenti di glucosio, le dosi di insulina, tiene traccia dell'insulina attiva, calcola le dosi d'insulina ai pasti e le dosi correttive.

CGM Simplera™ e penna intelligente per insulina InPen™



Sistema Smart MDI di nuova generazione

Fornisce ai tuoi pazienti raccomandazioni in tempo reale sulle dosi di insulina. L'app InPen™ combina i dati relativi all'insulina e ai valori di glucosio per raccomandare la dose corretta di insulina per i pasti.*



Sistema CGM Simplera™

Un CGM all-in-one monouso che offre un'esperienza di inserimento e di indossabilità semplice, con un design discreto.



Penna intelligente per insulina InPen™

Invia informazioni sulle dosi di insulina all'applicazione InPen™ dei tuoi pazienti.

Una panoramica completa dei dati relativi al glucosio, alle dosi d'insulina e ai pasti dei tuoi pazienti.

Il sistema Smart MDI facilita conversazioni basate su dati con i pazienti grazie a report semplificati e approfonditi.

Report panoramica


Statistiche

Include le dosi di insulina dimenticate

Distribuzione giornaliera del glucosio


Impostazioni modificabili

Include le impostazioni del calcolatore di dosi di insulina del paziente

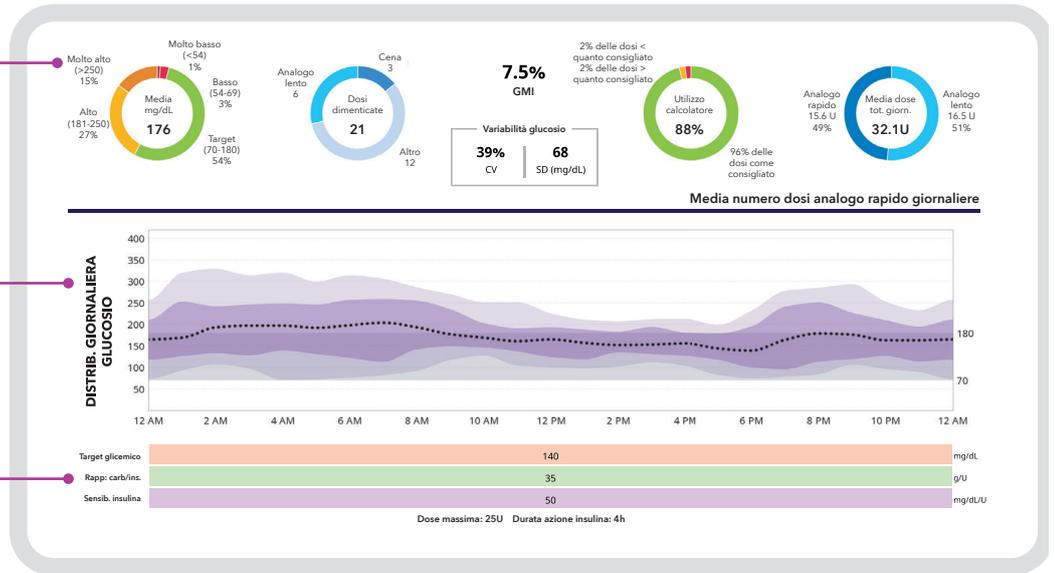

Report giornaliero

Dati del CGM e di insulina combinati. Vengono evidenziate le dosi di insulina dimenticate.

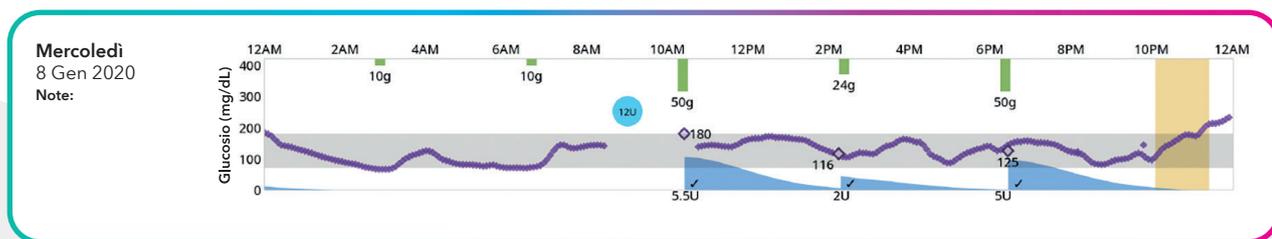

* Raccomandazione di dosaggio calcolata in base alle impostazioni iniziali dell'operatore sanitario e alla quantità di carboidrati stimata dall'utilizzatore.

Questo materiale non sostituisce né sostituisce le istruzioni per l'uso. Non deve essere considerata l'unica fonte di informazioni e deve essere utilizzata insieme alla Guida per l'utente. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante Medtronic locale e/o consultare il sito web Medtronic all'indirizzo medtronic.eu.

Nonostante le ragionevoli precauzioni prese nella redazione del presente documento, Medtronic non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni, né per gli usi dei materiali ivi contenuti o le decisioni basate su tali usi. Il presente documento non contiene tutte le informazioni necessarie per una cura e un trattamento completo del paziente. Per tali ragioni, nessun soggetto può affidarsi alle informazioni ivi presentate per l'elaborazione di un programma di trattamento completo o per la terapia del paziente. Non vengono fornite garanzie, espresse o implicite, per quanto riguarda i contenuti del presente documento o la relativa applicabilità a pazienti o circostanze specifiche. Per un elenco completo di indicazioni, controindicazioni, avvertenze e precauzioni dei dispositivi citati, si prega di consultare le istruzioni per l'uso dei singoli dispositivi.

Medtronic non può essere ritenuta responsabile in alcun modo per danni dovuti all'utilizzo o alla interpretazione non corretta dei contenuti del presente documento.

IT-CGM-2300003 © 2023 Medtronic. Medtronic e il logo Medtronic sono marchi di Medtronic™*. I marchi di terze parti sono marchi di proprietà dei rispettivi proprietari. Tutti gli altri marchi sono marchi della società Medtronic

Medtronic

Italia
 Medtronic Italia S.p.A
 Via Varesina, 162
 IT-20156 Milano (MI)
 Tel. +39 02 24137261
 Fax. +39 02 24138210

wepartner.medtronic-diabetes.com